

文書番号 K21-011A

管渠流量計

*UVH-3000*

排水JIS対応版

取扱説明書

**TOKYO**  
**KEIKI**

## 安全に関する注意







安全に関する重要な内容ですので、よくお読みの上、記載事項を必ずお守りください。

本書は当社の流量計を御使用になる方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に、正しくお使いいただくための重要な内容を記載しています。次に示す内容（表示、図記号）をよく御理解の上、本文をお読みください。

なお、本書は必要なときにすぐに参照できるように、使いやすい場所に保管してください。

### 表示の説明

本書および製品本体で使用している安全に関する表示の意味は次のとおりです。

| 表示   | 表示の意味   |
|--|---|
|  危険   | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 <u>人が死亡または重傷</u> を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。               |
|  警告   | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 <u>人が死亡または重傷</u> を負う可能性が想定される内容を示しています。                         |
|  注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 <u>人が傷害</u> を負う可能性が想定される内容、及び <u>物的損害</u> のみの発生が想定される内容を示しています。 |
|     | 保護接地端子を示しています。  |
|     | 電源ラインが近くにあることを示しています。   |
|     | 静電気に注意が必要なことを示しています。  |

## ラベル

### (1) 警告ラベル

本製品には以下に示す警告ラベルが貼り付けされています。

#### 警告

- ・端子部に手を触れないでください。感電の原因になります。
- ・サービス員以外は分解しないでください。  
本体内部には高電圧部がありますので感電の原因になります。
- ・ヒューズを交換する場合は必ず電源を切ってください。  
感電の原因となります。
- ・保護接地を外さないでください。



### (2) 注意ラベル

本製品には以下に示す注意ラベルが貼り付けされています。

#### 注意

- ・作業前に取扱説明書を熟読してください。
- ・感電に注意してください。
- ・各コネクタに静電気をかけないように注意してください。
- ・配線する場合は必ず電源を切ってください。
- ・配線の極性に注意してください。
- ・保護接地端子は接地させてください。




### (3) 接地




#### (4) 定格ラベル

定格最大流量  $Q_3$ 、転移流量  $Q_2$ 、定格最小流量  $Q_1$ 、IP、精度等級を示します。  
注) □□□□には、各定格流量が記載されます。

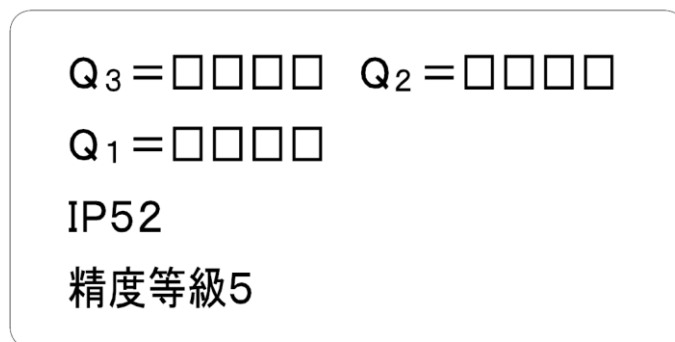

本装置で使用しているラベルと貼付位置は次のとおりです。

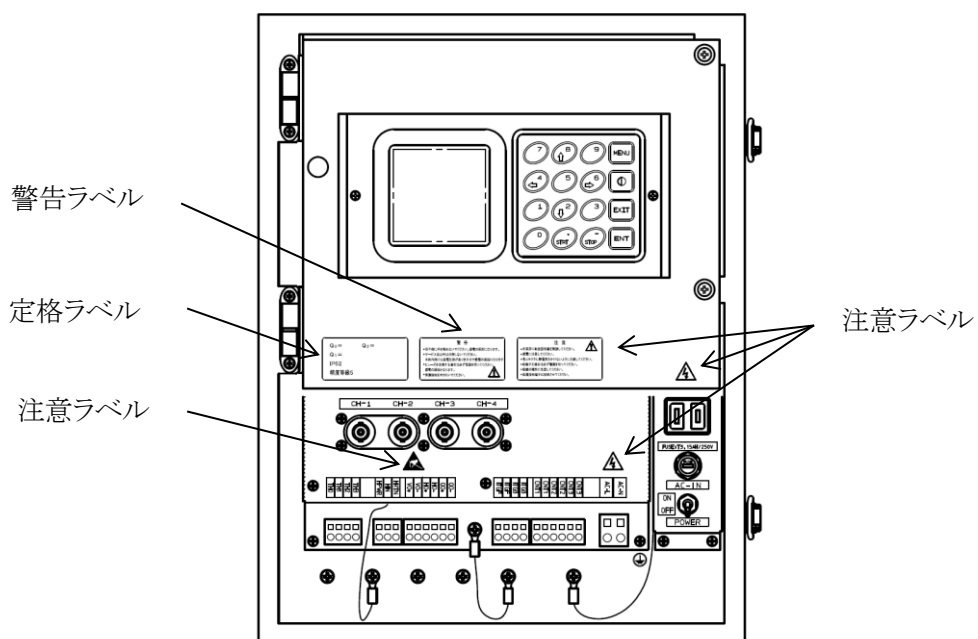

UVH-3000 パネル前面図

## 使用上の注意事項

|   |  |
|---|--|
| <p>製品の性能を十分に発揮させ、安全に御使用いただくために次の事項に注意して御使用ください。</p> |  |
| 注   | <p>①以下の事項をすべて満足しない場合には、測定不能、あるいは誤った計測値を表示又は出力することがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仕様書などに記載の所定の電源電圧範囲で使用すること。</li> <li>・測定中には超音波の伝搬を著しく妨げるような気泡や異物の混入がないこと。</li> <li>・流速検出器の設置には、必要直線部を満足するような場所を選択すること。</li> <li>・検出器には特に振動や衝撃が加わらないようにすること。</li> <li>・流量計本体、検出器、及びケーブルは外来ノイズなどの影響のない場所に設置すること。</li> <li>・流量計本体及び検出器は所定の周囲温度湿度の範囲で使用すること。</li> <li>・自然流下による流れであること。等流とみなせる流れであること。</li> <li>・水路には木材などの固く重い漂流物が流れてこないこと。</li> <li>・水路には土砂の堆積などがないこと。</li> </ul> |
| 意   | <p>②流速演算部及び水位計が必要な信号レベルを検知できなかった場合には、本体内液晶表示器にV E R RやH R O F F、H H A L T警報が表示されます。これらが表示されているとき、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・流速や水位は、警報が表示される直前の値を表示していることがあります。</li> <li>・流量は【R O F F O P E】の設定に従った値を表示していることがあります。</li> </ul>  |
|   | <p>③流量計本体で設定値の入力（最大流量、積算単位など）を行う場合には取扱説明書をよくお読みの上、正確に設定してください。誤った設定を行うと測定不能、あるいは誤った測定値（出力信号）を表示、又は出力します。</p>   |
|   | <p>④製品の改造、及び分解は行わないでください。感電や故障の原因となります。</p>  |
|   | <p>⑤この取扱説明書を紛失した場合には、最寄りの当社営業所まで御連絡ください。</p>   |
|   | <p>⑥本製品を廃棄する場合には、各自自治体の法規に従ってください。</p>   |

## はじめに

この取扱説明書は管渠流量計UVH-3000の安全に関する注意をはじめ、仕様、構造、設置、操作方法、故障とその対策、などについて詳しく説明してあります。本機器を十分御理解のうえ、正しくお使いくださるようお願いいたします。

## 取扱説明書等の遵守事項

この取扱説明書等について守っていただきたい事項は以下のとおりです。

1. この取扱説明書を熟読してください。  
この取扱説明書には重要なことが記載されていますので、必ず最後までお読みください。
2. この取扱説明書は大切に保管ください。  
本機器を取り扱う場合にはこの取扱説明書が必要です。この取扱説明書がいつでも読めるように、保管の御担当者や保管場所を決め大切に保管してください。
3. この取扱説明書を本機器の取扱者の手元に届けてください。  
代理店等、本機器の販売の仲介になる方々は、この取扱説明書を実際に本機器を取り扱う方々の手元に必ず届けてください。
4. この取扱説明書を紛失した場合は直ちに補充してください。  
この取扱説明書を紛失した場合には、裏表紙に示す当社営業所等に連絡し取扱説明書を補充してください。なお、補充の取扱説明書は有料です。
5. 警告ラベルのはがれのないことを確かめてください。  
警告ラベルが汚れたり、はがれたりした場合は、当社営業所等に連絡し警告ラベルを補充してください。なお、補充の警告ラベルは有料です。

## 取扱説明書等の注意事項

この取扱説明書は本機器の標準仕様に基づき作成されています。  
お客様の仕様により承認図面と異なる記述内容がある場合には、承認図面を優先させていただきます。

## 機器保護のための禁止事項及び注意事項

本機器の保護のため、以下の事項を守ってください。

1. 流量計本体や検出器を落とすなど、衝撃を与えないでください。
2. 規定の動作環境（周囲温度、周囲湿度）以外で使用しないでください。
3. 規定の電源以外で使用しないでください。

4. 傷がついたケーブル、被覆のはがれたケーブル（電源ケーブル、同軸ケーブル、信号ケーブル）は使用しないでください。
5. 機器の内部には高電圧の回路などがありますので、通電中は端子部や機器の内部には絶対に触らないでください。
6. 機器の操作は流量計本体の表扉を開けたパネル上（液晶表示器、キーボード）で行います。パネル内部の電子回路（プリント基板や電子部品など）は触らないでください。
7. 機器の分解や改造は絶対に行わないでください。機器が異常の際には当社へ御連絡ください。
8. 本機器及び付属機器は防爆エリアでは使用できません。
9. 本機器に絶縁耐圧試験を行う場合は別途御相談ください。

## 目次

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 安全に関する注意                  | (1)  |
| 表示の説明                     | (1)  |
| ラベル                       | (2)  |
| 使用上の注意事項                  | (4)  |
| はじめに                      | (5)  |
| 取扱説明書等の遵守事項               | (5)  |
| 取扱説明書等の注意事項               | (5)  |
| 機器保護のための禁止事項及び注意事項        | (5)  |
| 第1章. 概説                   | 1-1  |
| 1. 1  特長                  | 1-1  |
| 1. 2  関連する取扱説明書           | 1-1  |
| 1. 3  用語の定義               | 1-1  |
| 第2章. 標準的な構成               | 2-1  |
| 2. 1  電波レベル計MRF-10を使用する場合 | 2-1  |
| 第3章. 各部の名称と機能             | 3-1  |
| 3. 1  本体前面                | 3-1  |
| 3. 2  パネル                 | 3-1  |
| 第4章. 操作方法                 | 4-1  |
| 4. 1  概要                  | 4-1  |
| 4. 2  起動及び停止方法            | 4-2  |
| 4. 3  キーボード               | 4-3  |
| 4. 4  画面の種類               | 4-5  |
| 4. 5  計測画面                | 4-6  |
| 4. 6  インフォメーション画面         | 4-10 |
| 4. 7  メニュー画面              | 4-10 |
| 4. 8  メニュー構成              | 4-11 |
| 4. 9  【USER】項目の設定         | 4-12 |
| 4. 9. 1 SELF CHECK        | 4-13 |
| 4. 9. 2 BASIC DATA        | 4-13 |
| 4. 9. 3 パスワードの設定          | 4-14 |
| 4. 9. 4 ACCESS LOG        | 4-15 |
| 第5章. 設置                   | 5-1  |
| 5. 1  本体の設置               | 5-1  |
| 5. 1. 1  設置場所の選定          | 5-1  |
| 5. 1. 2  設置               | 5-1  |
| 5. 2  検出器の設置              | 5-1  |
| 5. 2. 1  流速検出器            | 5-1  |
| 5. 2. 2  水位検出器            | 5-2  |
| 5. 3  配線                  | 5-2  |
| 第6章. 保守・点検                | 6-1  |
| 6. 1  検出器の保守・点検           | 6-1  |
| 6. 2  本体の保守・点検            | 6-1  |
| 第7章. 一般仕様                 | 7-1  |
| 7. 1  総合仕様                | 7-1  |
| 7. 2  本体仕様                | 7-2  |
| 7. 3  付加仕様                | 7-7  |
| 7. 4  水位計仕様               | 7-7  |



|                   |     |
|-------------------|-----|
| 7. 5 流速検出器仕様..... | 7-7 |
| 7. 6 水温検出端 .....  | 7-7 |
| 7. 7 オプション品.....  | 7-7 |
| 第8章. 流量計測定原理..... | 8-1 |
| 営業所一覧 .....       | 9-1 |

## 第1章. 概説

このたびは当社の管渠流量計UVH-3000をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。御使用に先立ちこの取扱説明書を御一読くださいますようお願い申し上げます。なお性能向上のため、仕様や外観を予告なく変更することがありますので、予め御了承願います。

本書は排水JIS対応版の取扱説明書です。JIS B 7557:2019 排水流量計—取引又は証明用に対応しています。排水JIS非対応のUVH-3000をご購入の場合は取扱説明書が異なりますので最寄りの当社営業所まで御連絡ください。

UVH-3000は下水、農水、産業排水などの自由水面を持って流れる水路の水位と流速を計測し、これら2つの情報を元に流量を求める方式の流量計です。以下の特長を持ちます。

### 1. 1 特長

- (1) 水位検出器として、当社の電波レベル計MRF-10を使用しているため（標準仕様）、測定対象に接触することなく、水位を精度良く測定することができます。
- (2) MRF-10の代わりに、他の水位計も使用可能です。
- (3) 当社水位計を使用する場合、水位零から満水までの流量測定ができます。また流速検出器は小型のため、流れに障害を生じにくく、かつ取り付けが容易です。
- (4) 流量信号、流速信号、水位信号を独立して出力することができます。
- (5) JIS B 7557:2019 排水流量計—取引又は証明用に対応しています。

### 1. 2 関連する取扱説明書

平面アンテナ電波レベル計 MRF-10 取扱説明書 [文書番号 K08-004]

### 1. 3 用語の定義


流速には点流速と平均流速とがありますが、本書では平均流速のことを単に流速として表現しています。点流速と平均流速については第8章を御覧ください。

(このページは意図的に白紙にしています)

## 第2章. 標準的な構成

### 2. 1 電波レベル計MRF-10を使用する場合

|       | 名称     | 数量 | 説明                           |
|-------|--------|----|------------------------------|
|       | 本体     | 1台 | 流量計本体                        |
| 流速計用  | 検出器    | 1個 | 超音波の送受を行うセンサ                 |
|       | 同軸ケーブル | 1本 | 5C-2WAE                      |
|       | その他    | 1式 | 検出器と同軸ケーブルを接続するための結合材又は結合箱など |
| 水位計用  | 検出器・本体 | 1個 | MRF-10                       |
|       | ケーブル   | 1本 | 流量計本体とMRF-10接続用              |
| 水温検出用 | 検出端    | 1個 | TH-200またはTH-100              |
|       | ケーブル   | 1本 | 流量計本体と水温検出端接続用               |

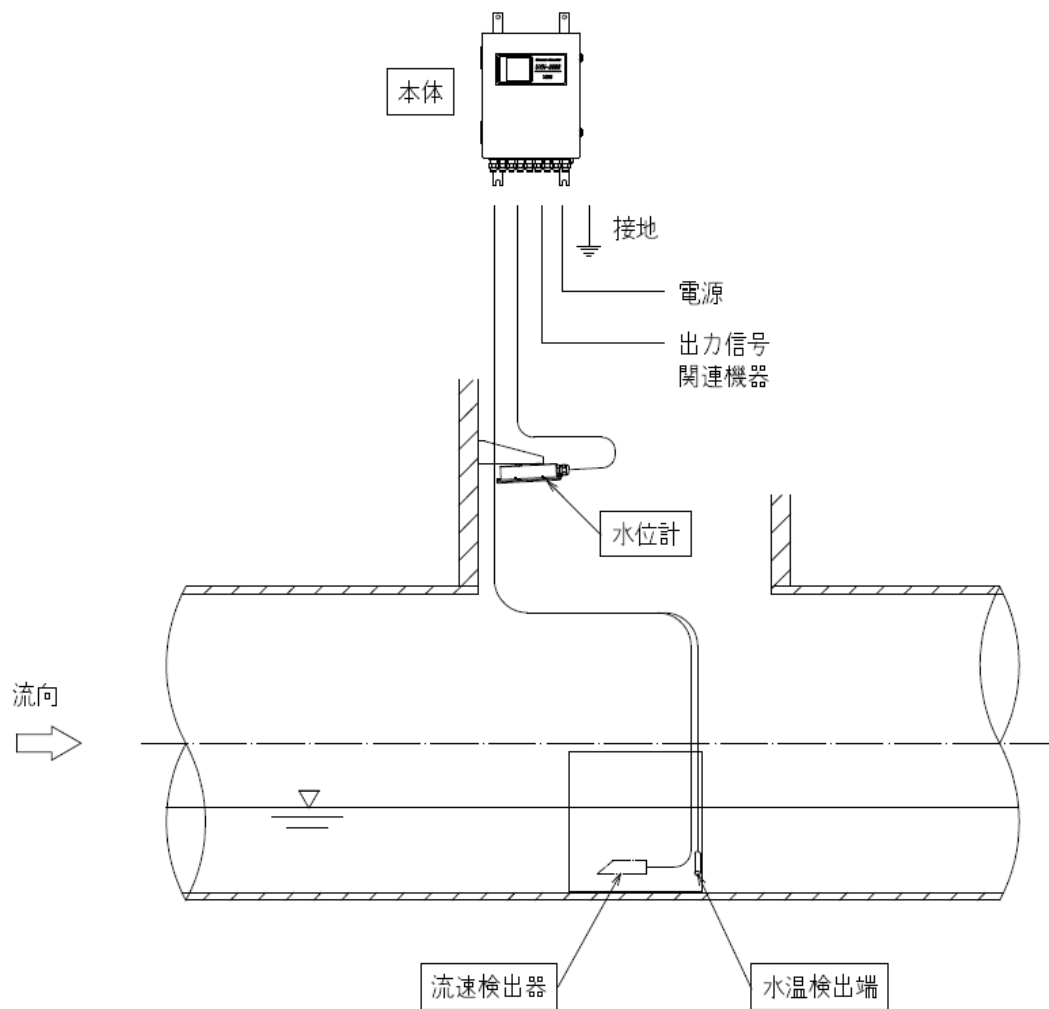

現場によって設置方法が異なる場合があります

図2-1 基本構成図

## 第3章. 各部の名称と機能

### 3. 1 本体前面

本体前面からは、流量値や積算値を表示するための①液晶表示器を見ることができます。

本機器の起動、停止及びメニュー操作は⑤パネル上で行います。パネルを見えるようにするには③パチン錠をはずし、④表扉を左方向に開きます。

キーの誤操作や防塵のため、通常は表扉を閉じた状態で御使用ください。

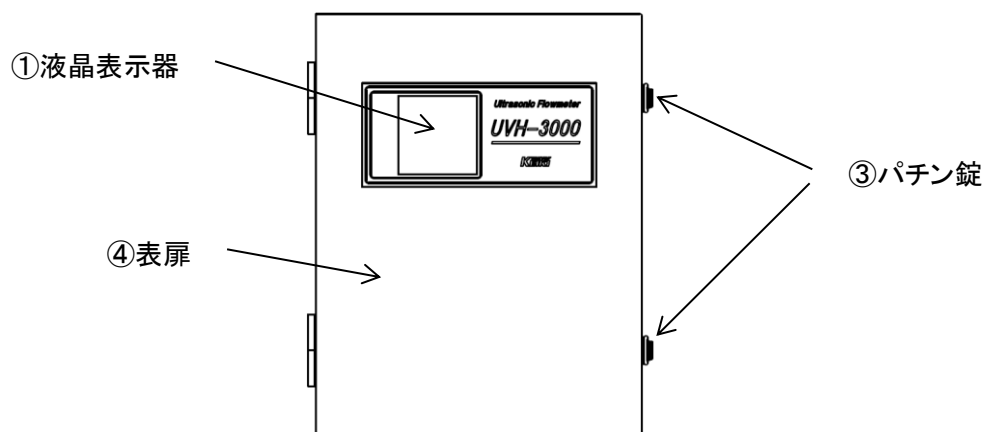


図3-1 本体前面

### 3. 2 パネル

④表扉が開いている状態では下記の操作が行えます。

- ・ ⑥電源スイッチによる本機器の起動や停止。
- ・ ①液晶表示器と②キーボードを使用した設定値の変更。
- ・ ⑨端子台群の配線作業。

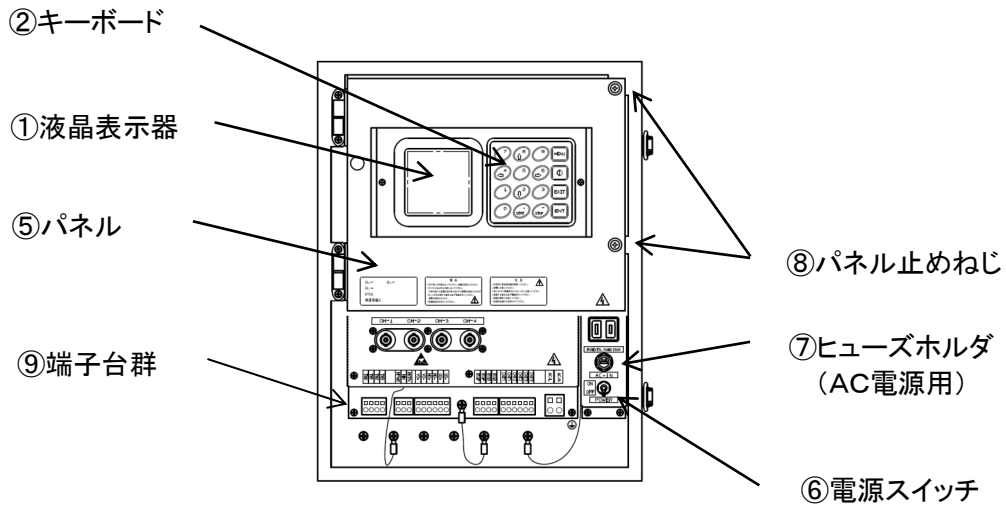


図3-2 パネル

⑧パネル止めねじをはずしてパネルを左方向に開けると二つの⑦ヒューズホルダが見えます。ヒューズの交換については6. 2 本体の保守・点検を御覧ください。

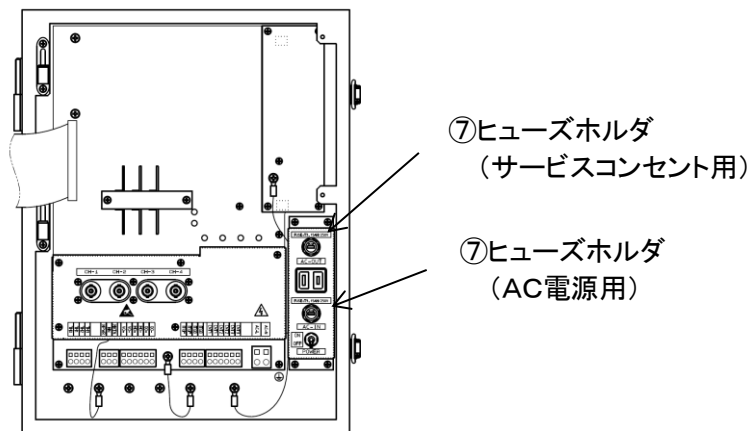


図3-3 パネルが開いている状態



**警告**

- ・端子部に手を触れないでください。  
感電の原因となる場合があります。
- ・サービス員以外は分解しないでください。  
本体内部には、高電圧部分があるので感電の原因となります。

## 第4章. 操作方法

### 4. 1 概要

本章では、本機器の起動及び停止方法、計測画面の見方、メニュー画面の操作方法等を説明します。

本機器は、原則として現地調整時に仕様に合わせて当社サービス員が設定いたしますので、調整後は電源を投入していただくだけで基本的な計測を簡単に行うことができます。

本機器のデータ設定等の操作は機器内部のキーボードによって行います。キー操作は、表示器を通じた対話形式で行いますので、容易に操作、変更が可能です。

操作に当たっては、各検出器およびケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

#### 注意

- ・メニュー操作中、計測動作（積算を含む）は中断され、出力は直前の値が保持されま  
す。
- ・積算中にメニュー操作に入ると、操作終了後は直前の値を引き継いで積算を再開しま  
す。
- ・アナログ出力チェック機能の動作中、積算動作は継続されます。
- ・メニュー操作で変更した設定値等は、計測動作を再開した時に反映されます。



## 4. 2 起動及び停止方法

### (1) 起動

- 電源スイッチをONにします。

設定が完了している状態であれば、起動後は自己診断を経て自動的に計測動作を開始します。

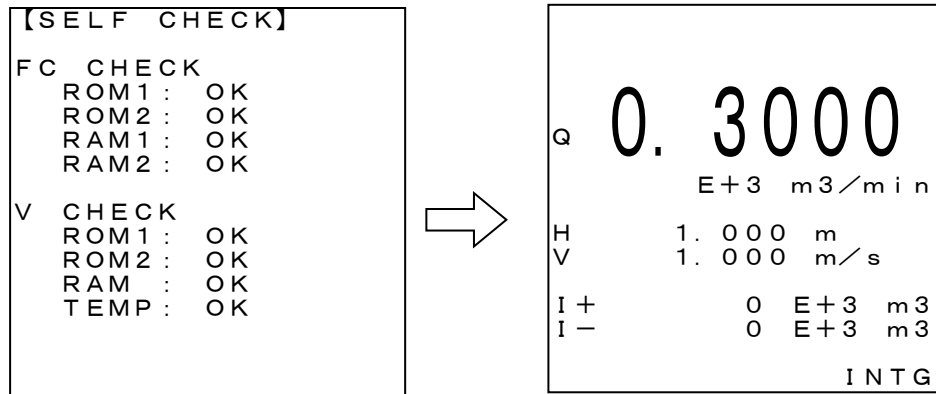


図4-2 電源投入時の画面

### (2) 停止

- 電源スイッチをOFFにします。

停止した場合でも、計測に必要な設定データは内部の不揮発性メモリに保持されています。

### 4. 3 キーボード

下図左のキーボードを、模式的に下図右のように表して説明します。

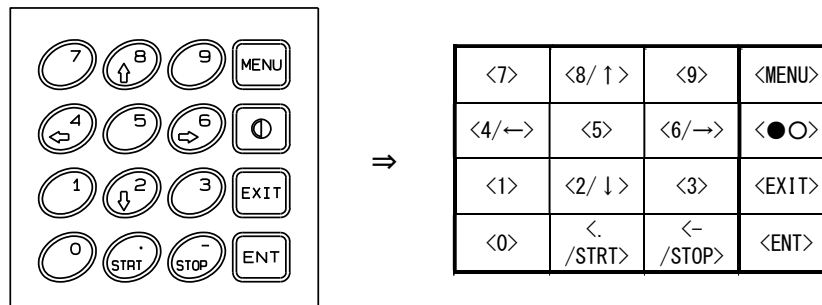


図 4-3 キーボード

キーには、原則として以下の機能が割り振られています。

表 4-3 原則的なキーの機能

| (*1) (*2)                                       | 計測画面                          | インフォメーション画面    | メニュー画面  |   | 手動ゲイン設定の画面  |
|---|-------------------------------|----------------|---|---|---|
|   |                               |                | 選択肢の選択  | 数値の入力   |   |
| <MENU>  | インフォメーション画面に移動<br>この時点では計測を継続 | 無効             | 選択肢の選択<br>計測画面へ戻る。  | 数値の入力<br>←  | ・計測画面に戻る。<br>・<ENT>済み項目のみ更新   |
| <●○><br><EXIT>                                  | 無効<br>無効                      | 無効<br>計測画面に戻る。 | ←<br>・画面の指示に従い計測画面または前画面へ戻る。<br>・ただし特記無き場合は、前ステップへ戻る。すなわち<br>・選択肢選択中で<ENT>前なら前回設定されていた選択肢に戻る。<br>・前回設定されていた選択肢に戻っているなら前画面に戻る。<br>・以下前画面に戻る。 | ←<br>・前ステップへ戻る。<br>すなわち<br>・数値入力中で<ENT>前ならバックスペース相当。<br>・入力中の数値が全桁消去されているなら前回設定されていた数値に戻る。<br>・前回設定されていた数値に戻っているなら前画面に戻る。<br>・以下前画面に戻る。 | ←<br>・前ステップへ戻る。<br>すなわち<br>・ゲイン設定中で<ENT>前なら前回設定されていたゲイン値に戻る。<br>・前回設定されていたゲイン値に戻っているなら前画面に戻る。<br>・以下前画面に戻る。 |
| <ENT>   | 無効                            | メニュー画面に移動      | 確定し次ステップへ移動   | ←   | ←   |
| 数値入力キーとしての<br><0>~<9>、<br><./STRT>、<br><-/STOP> | 無効                            | ←              | ←   | 数値扱い  | 無効  |

| (*1) (*2)    | 計測画面   | インフォメーション画面 | メニュー画面                   |          | 手動ゲイン設定の画面 |
|--------------|--|-------------|--------------------------|----------|------------|
|              |  |             | 選択肢の選択                   | 数値の入力    |            |
| 数値入力キー以外としての |  |             |                          |          |            |
| <./STRT>     | 積算ON時：<br>積算値のリセット及び積算開始。積算動作中は無効<br>積算OFF時：<br>無効 | 無効          | ←                        | . (小数点)  | 無効         |
| <-/STOP>     | 積算ON時：<br>積算停止。積算停止中は無効<br>積算OFF時：<br>無効           | 無効          | ←                        | - (マイナス) | 無効         |
| <8/↑>        | 無効   | 無効          | 前の項目へ移動<br>または前のパラメータを選択 | 8        | ゲイン値増      |
| <2/↓>        | 無効   | 無効          | 次の項目へ移動<br>または次のパラメータを選択 | 2        | ゲイン値減      |
| <4/←>        | 無効   | 無効          | 前のメニューに移動                | 4        | 無効         |
| <6/→>        | 無効   | 無効          | 次のメニューに移動                | 6        | 無効         |

(\*1) 同列上部の動作中に、同行左部のキーがどのような機能を果たすかを示しています。

(\*2) キーはリピート動作をします。

#### 4. 4 画面の種類

画面の種類は計測画面、メニュー画面、インフォメーション画面があり、それぞれの画面には、図4-4に示す関係があります。

計測画面で<MENU>キーを押すと、ソフトウェアのバージョン等を表示するインフォメーション画面が表示されます。

インフォメーション画面でパスワードを入力して<ENT>キーを押すと、メニュー画面【USER】が表示されます。

メニュー画面で<MENU>キーまたは<EXIT>キーを押すと計測画面に戻ります。


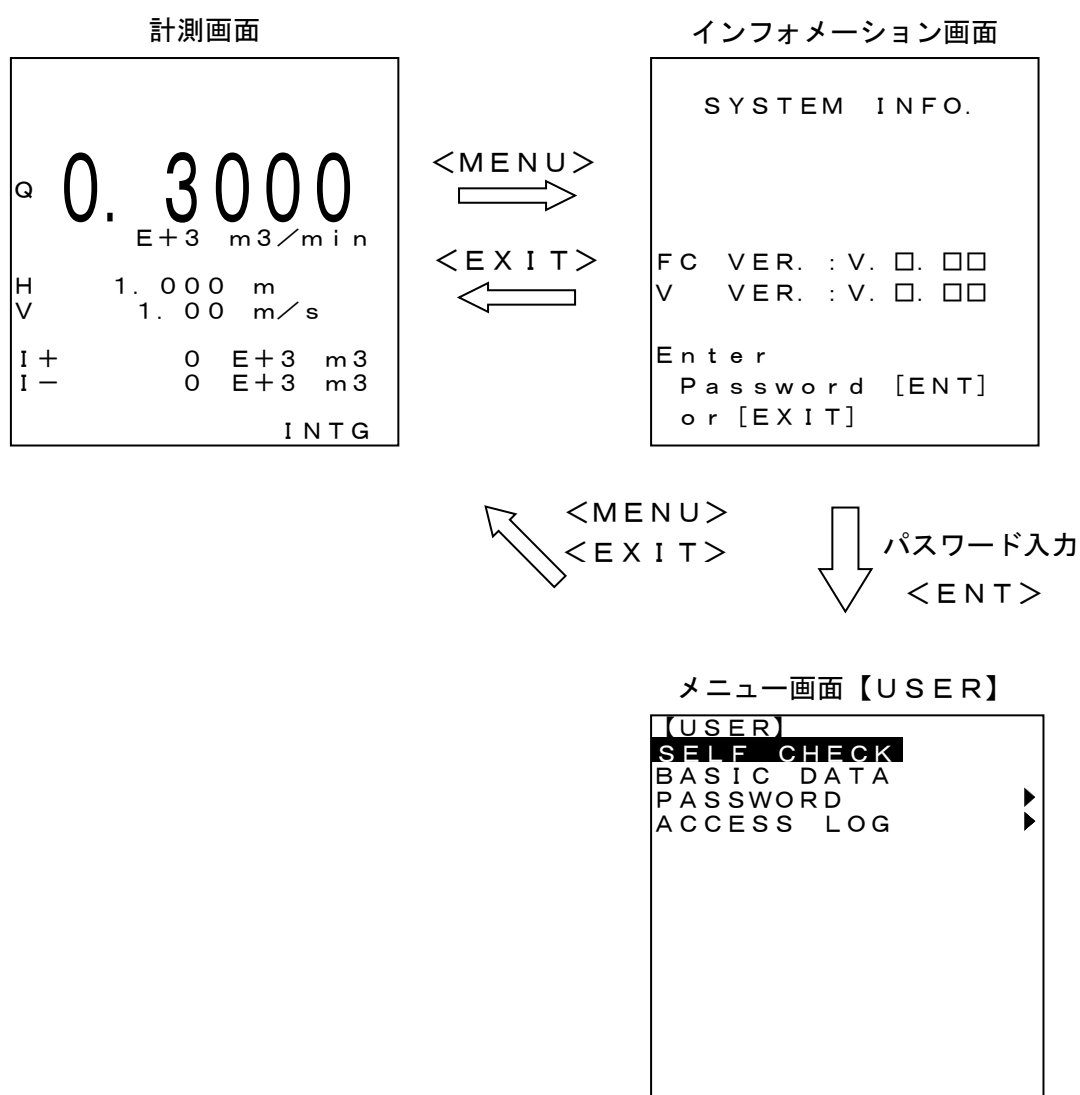


図4-4 計測画面とメニュー画面

## 4. 5 計測画面

計測動作中の表示器画面は以下のようになります。  
 下図は、説明用表示例です。

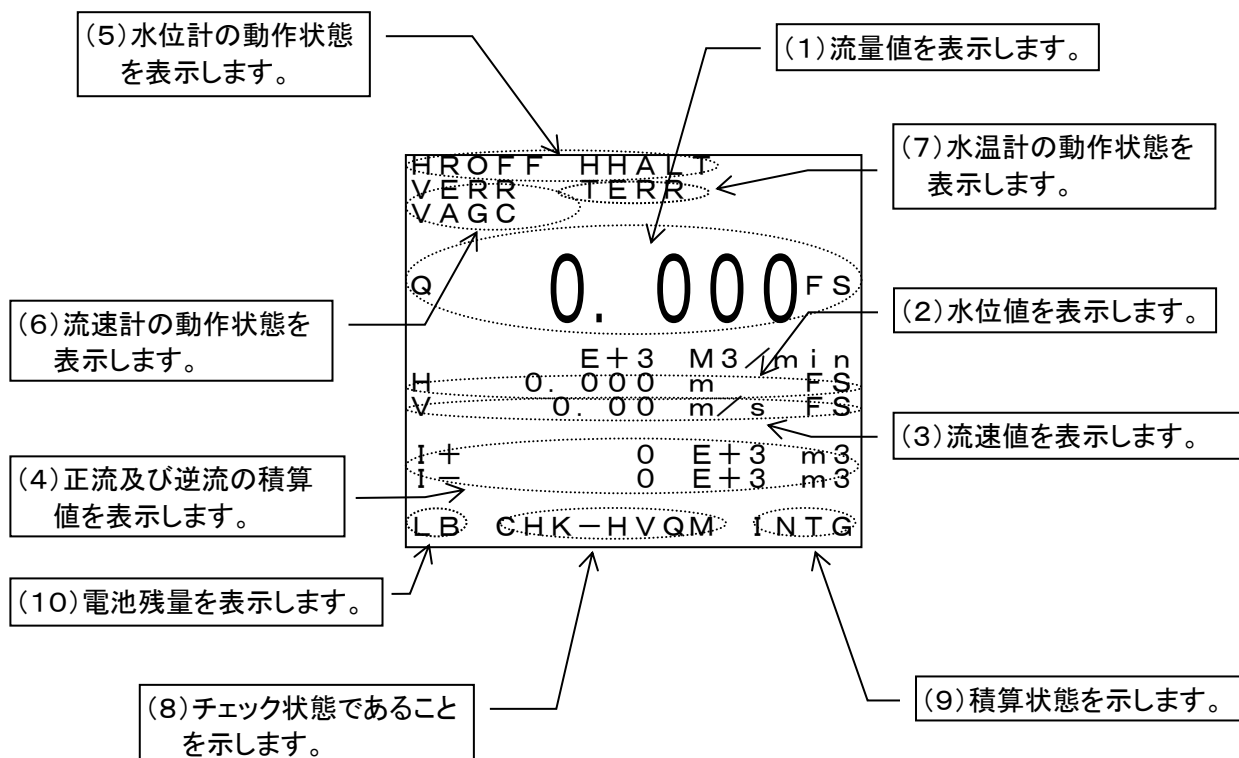

### (1) 流量値

単位、乗数、及びF S（フルスケールを意味します）は工場出荷時に設定します。  
 F Sは設定した値を超えたとき表示します。  
 お客様による変更はできません。変更の際は当社サービス員にお申し付けください。

### (2) 水位値

単位はm（メートル）固定です。  
 F S（フルスケールを意味します）は工場出荷時の設定値を超えたとき表示します。  
 お客様による変更はできません。変更の際は当社サービス員にお申し付けください。

### (3) 流速値

単位はm/s（メートル/秒）固定です。

FS（フルスケールを意味します）は工場出荷時の設定値を超えたとき表示します。  
お客様による変更はできません。変更の際は当社サービス員にお申し付けください。

### (4) 正流及び逆流の積算値

正流（I+）、逆流（I-）、及び積算単位の設定は工場出荷時に行います。  
お客様による変更はできません。変更の際は当社サービス員にお申し付けください。

### (5) 水位計の動作状態

下記を意味します。

| 表示            | 意味                                       | 水位アナログ出力           | HERR接点出力 |
|---------------|--|--------------------|----------|
| 表示なし          | 正常動作。                                    | 水位を4-20mAに換算し出力。   | 開        |
| HROFF<br>(*1) | 水位計の入力端子の信号が20mAを超えた。<br>水位計にて受波なしが発生した。 | 直前の値を4-20mAに換算し出力。 | 閉        |
| HHAALT        | 水位計の入力端子の信号が4mAより下がった。                   | 直前の値を4-20mAに換算し出力。 | 閉        |

(\*1) 使用する水位計により動作が異なることがあります。

### (6) 流速計の動作状態

下記を意味します。

| 表示   | 意味                        | 流速アナログ出力           | VERR接点出力 |
|------|---------------------------|--------------------|----------|
| 表示なし | 正常動作。                     | 流速を4-20mAに換算し出力。   | 開        |
| VERR | 1つまたは複数のセンサにおいて受波なしが発生した。 | 流速を4-20mAに換算し出力。   | 閉        |
|      | すべてのセンサにおいて受波なしが発生した。     | 直前の値を4-20mAに換算し出力。 |          |

| 表示   | 意味                   |
|------|----------------------|
| VAGC | VAGC : AGCがONになっている。 |

(7) 水温計の状態

下記を意味します。

| 表示   | 意味                | TERR接点出力 |
|------|-------------------|----------|
| 表示なし | 正常動作。             | 開        |
| TERR | 水温が指定範囲外の値になっている。 | 閉        |

(8) チェック状態

下記を意味します。

| 表示       | 意味    |       |       |               |
|----------|-------|-------|-------|---------------|
|          | Hチェック | Vチェック | Qチェック | センサ切換<br>チェック |
| なし       |       |       |       |               |
| CHK-H    | ○     |       |       |               |
| CHK-V    |       | ○     |       |               |
| CHK-Q    |       |       | ○     |               |
| CHK-HV   | ○     | ○     |       |               |
| CHK-HQ   | ○     |       | ○     |               |
| CHK-VQ   |       | ○     | ○     |               |
| CHK-HVQ  | ○     | ○     | ○     |               |
| CHK-M    |       |       |       | ○             |
| CHK-HM   | ○     |       |       | ○             |
| CHK-VM   |       | ○     |       | ○             |
| CHK-QM   |       |       | ○     | ○             |
| CHK-HVM  | ○     | ○     |       | ○             |
| CHK-HQM  | ○     |       | ○     | ○             |
| CHK-VQM  |       | ○     | ○     | ○             |
| CHK-HVQM | ○     | ○     | ○     | ○             |

○ : その機能が働いていることを意味します。

チェック項目で水位アナログ出力が設定されているとき“CHK-H”、流速アナログ出力が設定されているとき“CHK-V”、流量アナログ出力が設定されているとき“CHK-Q”が表示されます。水位、流速、流量アナログ出力をすべて設定すると“CHK-HVQ”と表示されます。

センサ切換チェック機能有効時は“CHK-M”が表示されます。

(9) 積算状態

INTGが表示されているときは積算中であることを示します。

#### (10) 電池残量

LBが表示されたときはメモリバックアップ用電池の電圧が規定値以下になったことを示します。また、LBが点滅しているときはメモリバックアップができていないことを示します。6.2 本体の保守・点検の(4)を参照してください。



## 4. 6 インフォメーション画面

計測画面の時に<MENU>キーを押すとインフォメーション画面が表示されます。  
ソフトウェアバージョン等を表示するインフォメーション画面は以下のようになります。

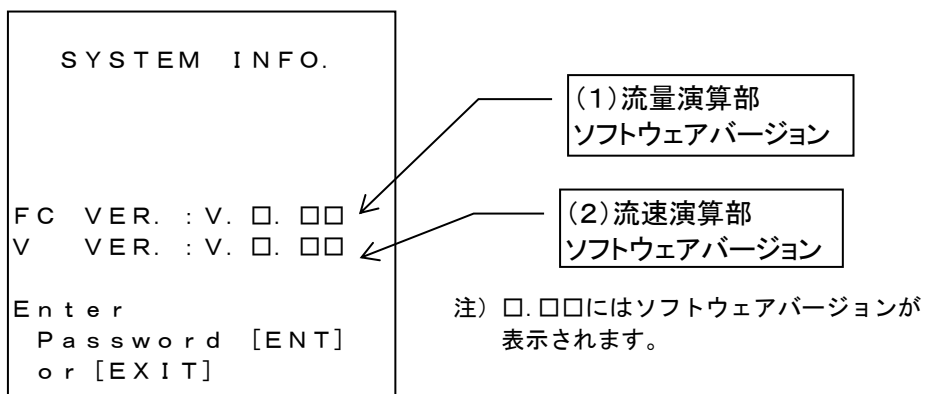


図4-6 インフォメーション

この画面が表示されているときにパスワードを入力して<ENT>キーを押すと、メニュー画面【USER】が表示されます。また、<EXIT>キーを押すと、計測画面に戻ります。

## 4. 7 メニュー画面

### (1) 項目選択方法

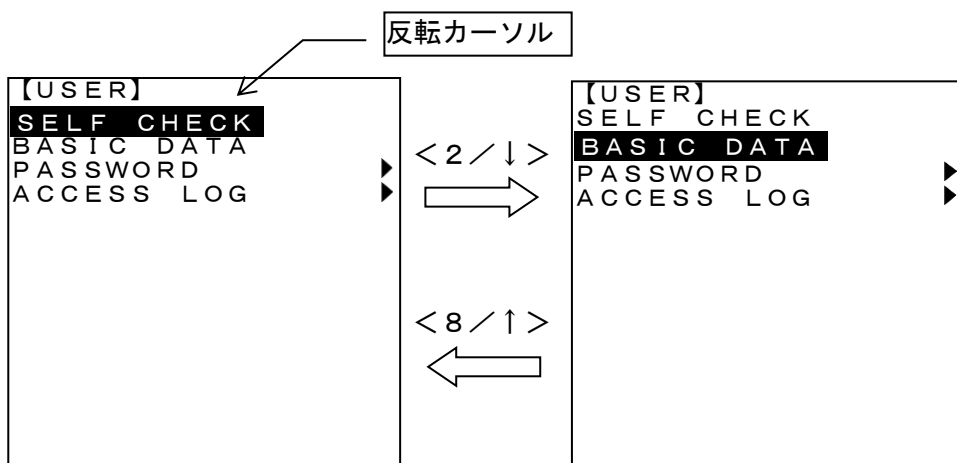



図4-7-1 項目選択

項目を選択するには、反転カーソルを<8/↑>キーまたは<2/↓>キーにて移動し、<ENT>キーを押します。

下位のメニューがあるときはそれを表示し、そうでない時は現在の設定値に対し、アンダーバーカーソルが点滅します。

注) 右側に ▶ のある項目は下位のメニューがあることを表しています。

## 4. 8 メニュー構成

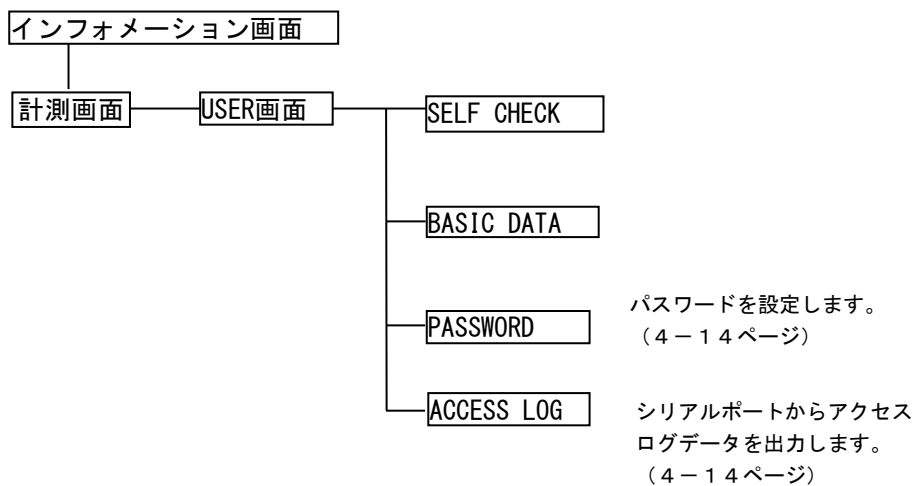

## 4. 9 【USER】項目の設定

【USER】画面では下記のパラメータを設定することができます。

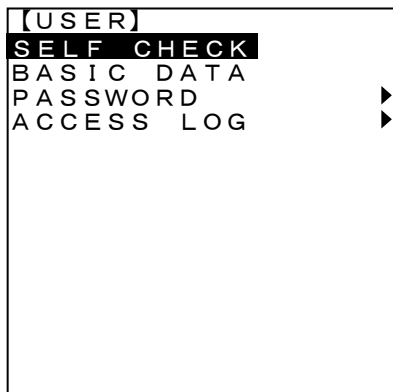


図4-9 USER画面

### 設定項目一覧

ここで設定できる項目を下表にまとめます。

| 設定項目       | 内容                        |
|------------|---------------------------|
| SELF CHECK | 自己診断を行います。                |
| BASIC DATA | 基礎データを表示します。              |
| PASSWORD   | パスワードを設定します。              |
| ACCESS LOG | シリアルポートからアクセスログデータを出力します。 |

⑩印の付いている項目は↑、↓（矢印）キーが有効になっていることを示しています。

⑫印の付いている項目は数字キーが有効になっていることを示しています。

## 4. 9. 1 SELF CHECK

【USER】画面で“SELF CHECK”を選択します。＜通常は使用しません＞

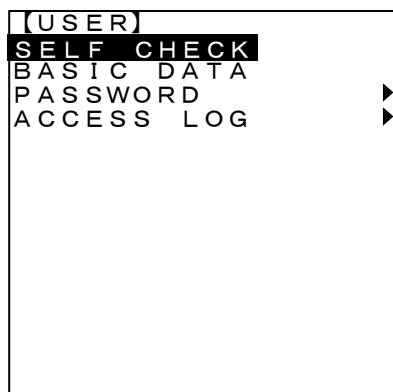


図4-9-1 a  
SELF CHECK実行画面

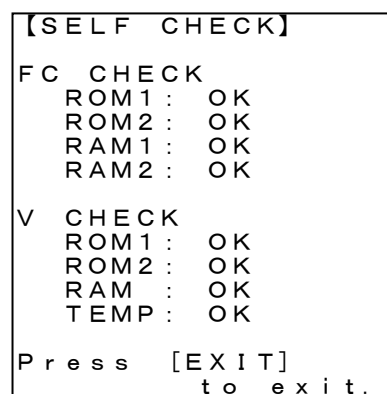


図4-9-1 b  
自己診断結果画面例

### SELF CHECK (注)

流量計本体の自己診断を実行します。“SELF CHECK”を選択し、＜ENT＞キーを押すと図4-9-1 bのような自己診断結果表示になります。

注) この項目は本機器に異常が生じた場合、故障究明の目安となるデータです。自己診断の結果“NG”が表示された場合には、当社営業所に連絡してください。

## 4. 9. 2 BASIC DATA

【USER】画面で“BASIC DATA”を選択します。＜通常は使用しません＞

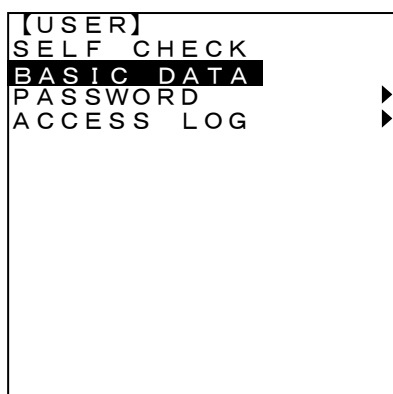


図4-9-2 a  
BASIC DATA選択画面

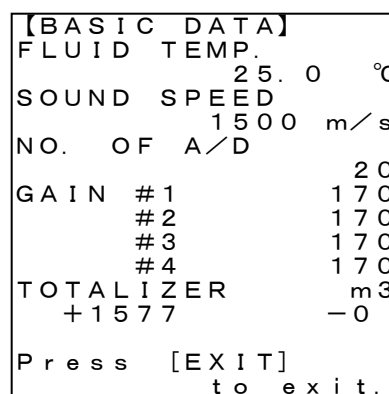


図4-9-2 b  
BASIC DATA表示画面例

BASIC DATAを選択し＜ENT＞キーを押すと基礎データを表示します。基礎データ表示画面例を図4-9-2 bに示します。基礎データ表示画面で＜EXIT＞キーを押し【CHECK】画面へ戻ってください。

注) この項目は本機器に異常が生じた場合、故障究明の目安となるデータです。

### 4. 9. 3 パスワードの設定

下記の5つのパスワード（初期値）が設定されています。

・0000、1001、2002、3003、4004

これらの各パスワードの下三桁を変更可能です。【USER】画面で”PASSWORD”を選択し、<ENT>キーを押すと図4-9-3 bのように新パスワードの下三桁の設定画面になります。下三桁を入力し<ENT>キーを押すと新パスワードが設定されます。**(123)**

設定したパスワードを忘れてしまった場合は、最寄りの当社営業所まで御連絡ください。

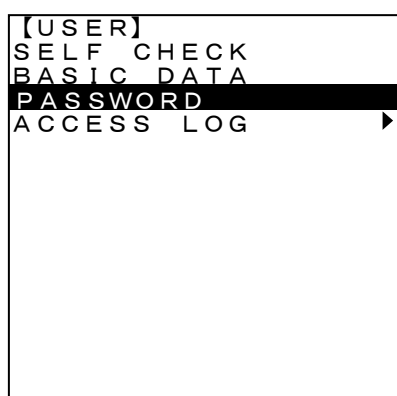


図4-9-3 a  
PASSWORDの選択画面

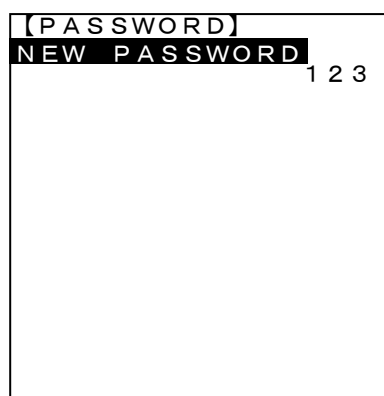


図4-9-3 b  
PASSWORDの設定画面

## 4. 9. 4 ACCESS LOG

### (1) PCへの接続

アクセスログ出力ケーブル（オプション品）で、UVH-3000をPCに接続します。パネルを開けて、図示のようにパネル裏面の基板の右上、[SET]と印字しているコネクタに、本ケーブルのモジュラを接続します。コネクタ（D-Sub 9ピンメス）はPCのシリアルポートに接続してください。

PCにシリアルポートがない場合は、本ケーブルとPCを市販のUSBシリアル変換ケーブルで接続してください。

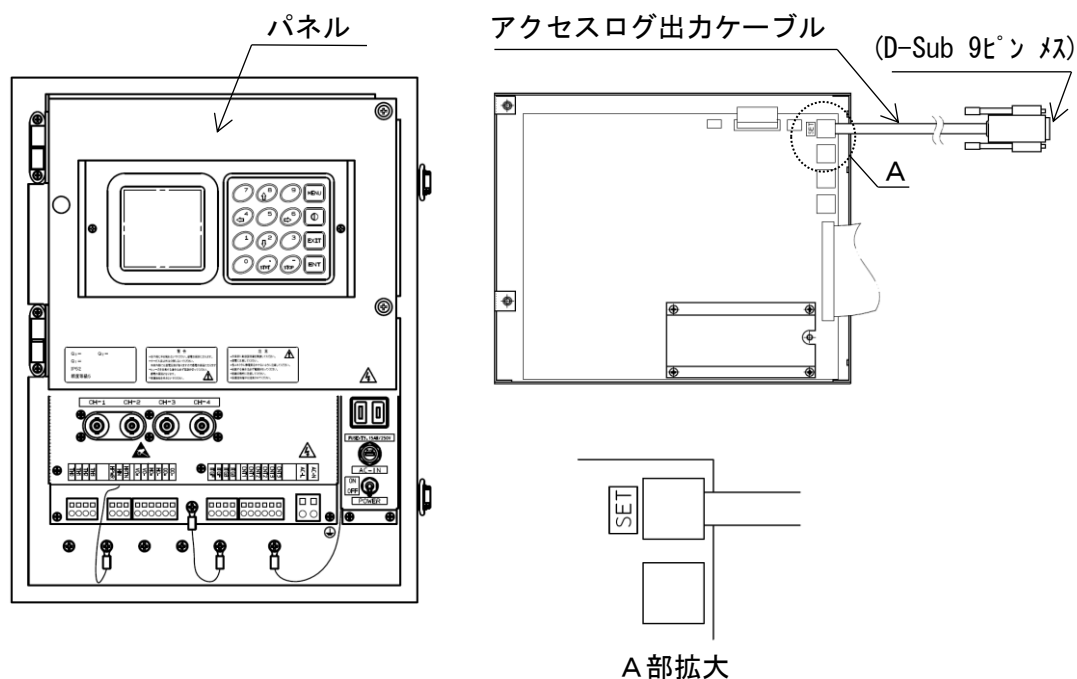


図4. 9. 4a ケーブル接続図



### 警告

- ・配線は活線状態で行わないでください。感電の原因となる場合があります。

### (2) ターミナルソフトの設定

PCのターミナルソフトの通信環境を以下のように設定にしてください。

- |          |                       |
|----------|-----------------------|
| ・ポート     | ご利用になるCOMポートを指定してください |
| ・通信速度    | 9600bit/秒             |
| ・データ     | 8bit                  |
| ・パリティ    | none                  |
| ・ストップビット | 1bit                  |
| ・フロー制御   | none                  |

(3) アクセスログ出力

【USER】画面で“ACCESS LOG”を選択し、<ENT>キーを押すと図4-9-4 cのようにアクセスログ設定画面になります。<ENT>キーを押すとシリアルポートから古い順にアクセスログデータを、CSV形式（カンマ区切り、ASCII）で出力します。

アクセスログの出力フォーマットは、「年，月，日，時，分，秒，パスワード」です。

アクセスログ出力終了後、<EXIT>キーを押すと【USER】メニューに戻ります。

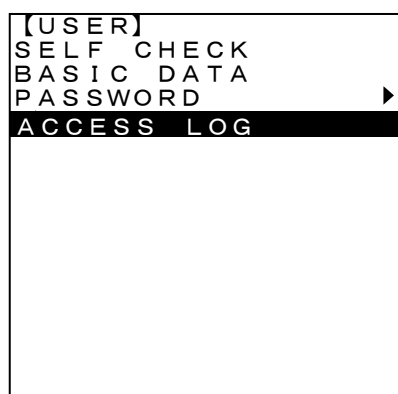


図4-9-4 b  
ACCESS LOG選択画面

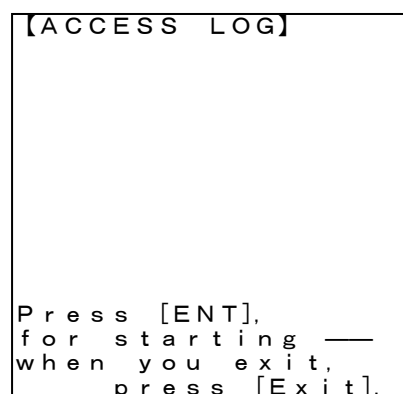


図4-9-4 c  
ACCESS LOG設定画面

## 第5章. 設置

管渠流量計UVH-3000を設置するに当たっては、機器の性能を十分に発揮できるよう、下記の各項に記載された条件を考慮して設置してください。

### 5. 1 本体の設置

#### 5. 1. 1 設置場所の選定

設置場所は下記の条件を考慮して選定してください。

- 1) 周囲温度 $-10\sim+5.5^{\circ}\text{C}$ 、近くに発熱体の少ない直射日光の当たらないところ
- 2) 埃や腐食性雰囲気のないところ
- 3) 保守、点検が容易にできるところ
- 4) 本体と検出端との距離が、ケーブル長さで下記以下であるところ  
電波レベル計MRF-10：300m
- 5) 動力機器及び同配線の誘導障害を受ける恐れのないところ

#### 5. 1. 2 設置

- 1) 本体は、垂直壁面に4本のM10ボルトで取り付けるなどの方法で確実に設置してください。
- 2) 保守点検のため作業エリアを確保してください。

### 5. 2 検出器の設置

#### 5. 2. 1 流速検出器

##### (1) 設置場所の選定

流速分布の乱れによる測定誤差を少なくし、流量計の性能を確保するために、流速検出器の取り付け位置の上下流には、表7-1に示す水路直線部が必要です。これ以外は当社に御相談ください。

##### (2) 設置

水路の中心を通る鉛直線上で底から標準で $0.1B$  ( $B$ :水路幅)に位置するように取り付け金具をアンカーボルト等で取り付けます。水路形状及び環境条件などにより、これ以外の設置方法を採用する場合があります。詳細につきましては当社にご相談ください。



## 5. 2. 2 水位検出器

### (1) 設置場所の選択

測定誤差を少なくし、流量計の性能を確保するために、水位検出器の取り付け位置に関しては一般に下記の条件が必要ですので御注意ください。詳細につきましては当社に御相談ください。

- 1) 流速検出器の上流側に設置する。
- 2) 近くに発熱体が少なく、直射日光の当たらないところに設置する。

### (2) 設置

取り付け金具をアンカーボルト等で取り付けした後固定します。

## 5. 3 配線

各機器の配線は本体接続端子盤を用いて配線されます。次の要領で配線してください。

- 1) 本体と検出器とを接続する同軸ケーブルは動力線などから分離し、動力機器に近接することのないような敷設をしてください。
- 2) 本体と外部機器の配線は図5-1、2及び表5-1を参照して行ってください。
- 3) 電源は必ず計装用電源を使用し、動力用電源と共用することは避けてください。
- 4) 電源及び信号ケーブルは公称断面積0.75~2mm<sup>2</sup>相当のケーブルを使用してください。
- 5) 線は銅製コンジット（電線管）配線としてください。本体の電源及び信号ケーブルの配線引き込みは、本体底面のスキントップを通して結線してください。従って電線管の配管端は本体底面の直近までとしてください。配線用の電線管は、銅製電線管（JIS C 8305）または金属製可とう電線管（JIS C 8309）を使用してください。
- 6) 本体ケースを下図Aの端子で接地してください。（第D種接地）
- 7) HPWR端子とHIN端子をショートさせないでください。内蔵電源が壊れる恐れがあります。
- 8) HIN端子とHRTN端子に直接電源を接続しないでください。内部回路が壊れる恐れがあります。



#### 警告

- ・配線の際は本体を停止し、通電を止めてください。  
感電の原因となる場合があります。
- ・誤配線のないようにしてください。  
本機器及び接続された機器に損傷を与える原因となる場合があります。

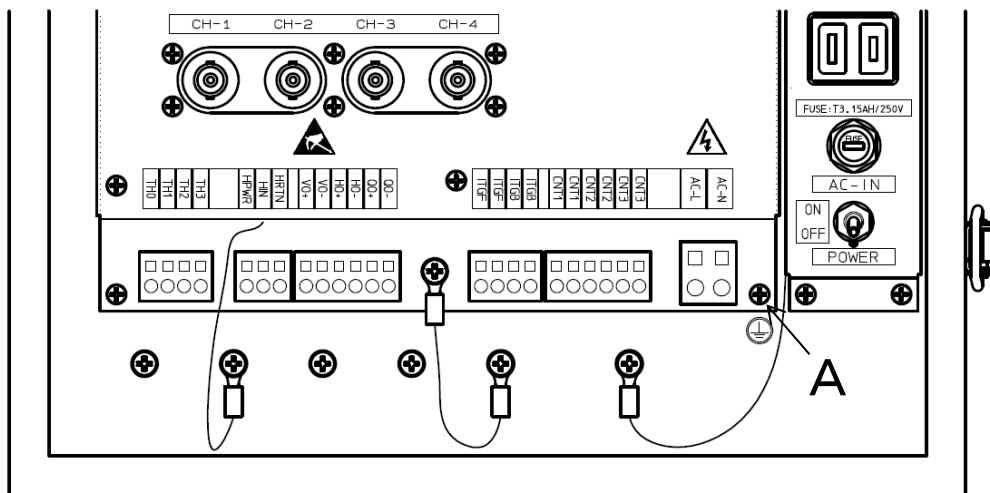


図5-1 本体外部接続用端子付近(電源仕様:AC100Vの場合)

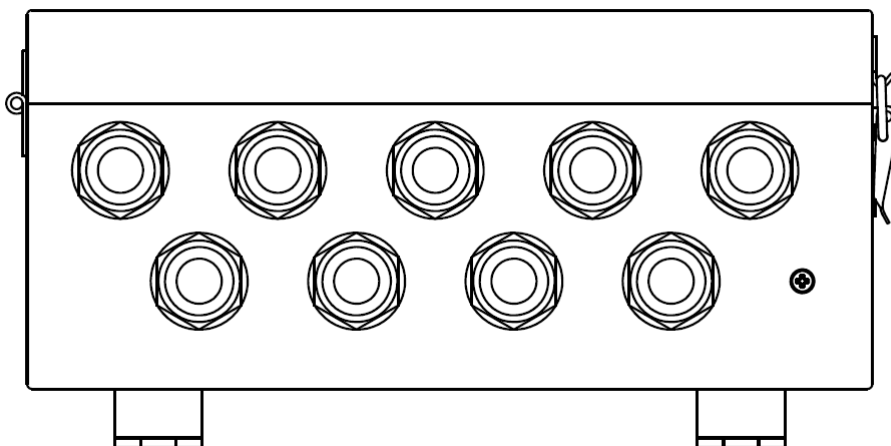


図5-2 本体ケース下面

表 5 - 1 本体端子台外部接続用端子

仕様又は設定により機能が制限される場合があります。

(1) 各種入出力用

| 端子名称 | 機能               | 端子名称 | 機能            |
|------|------------------|------|---------------|
| TH0  | 水温検出用端子0         | HO-  | 水位アナログ出力-端子   |
| TH1  | 水温検出用端子1         | QO+  | 流量アナログ出力+端子   |
| TH2  | 水温検出用端子2         | QO-  | 流量アナログ出力-端子   |
| TH3  | 水温検出用端子3         | ITGB | 逆流積算パルス出力接点端子 |
| HPWR | 水位計アナログ入力端子 (*1) | ITGF | 正流積算パルス出力接点端子 |
| HIN  | 水位計アナログ入力端子 (*1) | CNT1 | 異常警報出力1 (*2)  |
| HRTN | 水位計アナログ入力端子 (*1) | CNT2 | 異常警報出力2 (*2)  |
| VO+  | 流速アナログ出力+端子      | CNT3 | 異常警報出力3 (*2)  |
| VO-  | 流速アナログ出力-端子      |      |               |
| HO+  | 水位アナログ出力+端子      |      |               |

(\*1)水位計アナログ入力端子詳細

| 水位計                                    | 端子名称            |                 |               | 接続例    |
|--|-----------------|-----------------|---------------|--------|
|  | HPWR            | HIN             | HRTN          |        |
| DC24V±20%の電源で動作する2線式水位計                | 2線式水位計の(+)端子と接続 | 2線式水位計の(-)端子と接続 | X             | 図5-3-1 |
| 負荷抵抗350Ωを許容できるDC4-20mA出力を持つ水位計(4線式水位計) | X               | 電流出力の(+)端子と接続   | 電流出力の(-)端子と接続 | 図5-3-2 |

(注) HPWR-HIN端子をショートさせないでください。

(注) アナログ入力端子には電源を直接接続しないでください。故障の原因となります。

(\*2)異常警報出力端子詳細

下記を任意に出力可能(警報時:閉)

HERR、VERR、TERR、ALL、QBW、NONE

- HERR : 水位が指定範囲外の場合 (HROFF または HHALT 表示時)
- VERR : 流速計測にて断線が発生した場合 (VERR 表示時)
- TERR : 水温が指定範囲外の場合 (TERR 表示時)
- ALL : HERR + VERR + TERR
- QBW : 方向判別 (逆流時:閉、正流時:開)
- NONE : 異常警報出力無し (常時:開)

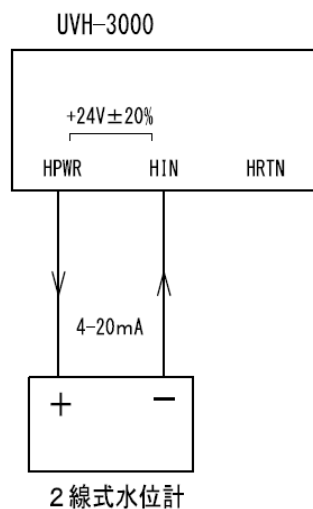


図5-3-1 2線式水位計との接続

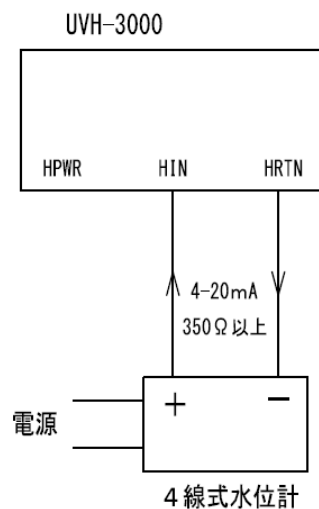


図5-3-2 4線式水位計との接続

(2) 電源用

| 端子名称 | 機能              |
|------|-----------------|
| AC-L | AC電源 ライブ極を接続    |
| AC-N | AC電源 ニュートラル極を接続 |

(注) 3極電源ケーブルの中の接地線は図5-1 Aの端子に接続します。

(3) サービスコンセント

電源仕様がAC 100Vの場合のみサービスコンセントを備えています。

(4) 流速検出器用 (BNC端子)

|   |                 |
|---|-----------------|
| CH-1  | 流速検出器第1測線用BNC端子 |
| CH-2  | 流速検出器第2測線用BNC端子 |
| CH-3  | 流速検出器第3測線用BNC端子 |
| CH-4  | 流速検出器第4測線用BNC端子 |
| (注) 多測線流速計測については7.3 付加仕様の「多測線流速計測」を参照してください |                 |

(このページは意図的に白紙にしています)

## 第6章. 保守・点検

### 6. 1 検出器の保守・点検

検出器は一般に保守の必要はありませんが下記の事項に注意してください。

- (1) 検出器に衝撃を与えないでください。  
堅いもので叩いたり、手をかけたり足で乗らないでください。
- (2) 締め付け部に力を加えないでください。  
検出器は取り付け金具にて正しい取り付け寸法位置で締め付けてありますので、力が加わると位置ずれ等が生じ測定不能になる場合があります。
- (3) 流速検出器は付着物の付きにくい構造ですが、長期間使用していると、まれに付着物が成長して大きくなったり、漂流物（木片など）が引っ掛かったりすることがあります。感度を低下させる原因になりますので、定期的に点検してください。付着物があるときは、ブラシなどで衝撃を与えないように取り去ってください。
- (4) 検出器は不良になった場合にも極端な場合を除いて外観上の差異が生じませんので、通常は当社が保守点検契約（別途仕様）に基づいて点検を行います。特性劣化の確認は超音波の受信波を観測し、正常時との比較で判断します。

### 6. 2 本体の保守・点検

当社の管渠流量計には機械的可動部品や電氣的駆動部品が使用されていませんので、一般に保守の必要はありませんが下記の事項に注意してください。

- (1) 警告ラベルは常に読み取れるよう点検・清掃してください。警告ラベルが汚れたりはがれたりした場合には当社に連絡してください。
- (2) ヒューズが断線した場合は、地落、短絡又は絶縁不良の有無及び供給電源の異常について確認してください。問題のないことが確認されたときは、ヒューズの交換を行います。問題のないことが確認できないとき、あるいは交換したヒューズが繰り返し断線するときは、当社に連絡してください。
- (3) 雷により誘導雷サージを受けると、避雷器内部のサージ吸収素子が劣化します。定期的な交換をお奨めします。劣化が進むと漏れ電流が増加し、電源側ではヒューズが働いて電源供給を遮断します。またアナログ出力側では、受信計器に正しく電流が送られなくなります。
- (4) 計測画面にLBが表示されたらメモリバックアップ用電池の交換が必要です。当社に連絡してください。
- (5) 計測値等の表示に使用しているLCDの寿命は常温環境で約5年です。寿命を過ぎたLCDは視認性に影響が出ますが、本体の流量計測機能や各種出力動作には影響を与えません。一般にLCDは直射日光が当たる環境や高温度の環境で使用すると寿命が短くなります。

- (6) 電源ユニットの寿命は本体周囲温度が平均40℃の環境で約10年です。電源寿命は内部の電解コンデンサの寿命で考えており、一般的には周囲温度が10℃上がる毎に半減し、逆に10℃下がる毎に倍になると考えます。
- (7) 使用しているパッキン類は次のとおりです。これらのパッキン類は使用環境により寿命が異なります。パッキンにひび割れや切断が確認された場合には、保護等級の性能を維持できませんので当社に連絡してください。

|             |
|-------------|
| 使用箇所        |
| 変換器（ケースフタ間） |
| ケーブルグランド    |



**警告**

- ・保守・点検の際は本体を停止し、通電を止めてください。  
感電の原因となる場合があります。
- ・当社指定のヒューズ以外は使用しないでください。

## 第7章. 一般仕様

### 7. 1 総合仕様

|      |           |   |
|------|-----------|---|
| 測定対象 | 種類        | 下水、産業排水、汚水など超音波を反射する浮遊粒子を含み、自由水面をもって流れる液体   |
|      | 流体温度      | 0～45℃   |
|      | その他       | 次のような場合は別途御相談ください<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・液面に多量の気泡やゴミなどがある</li> <li>・液面に大きな波立ちがある</li> <li>・液体中に多量の気泡やゴミなどを含んでいる</li> <li>・水路に木材などの固く、重い漂流物が流れてくる</li> <li>・水路に土砂の堆積などがある</li> </ul> |
| 適用水路 | 種類        | 矩形、円形   |
|      | 寸法        | 円形水路 : $\phi 0.25 \sim 5 \text{ m}$<br>その他の水路 : 水路幅 $0.25 \sim 5 \text{ m}$<br>ただし水位計の水没なきこと  |
|      | 直線部長さ     | 表7-1を参照   |
| 測定範囲 | 流量        | 0～満水位流量   |
|      | 水位        | 0～5 m<br>(注) 使用する水位計に制限される  |
|      | 流速        | 正流 : $0 \sim 5 \text{ m/s}$<br>逆流 : 判別可能  |
| 演算周期 | 約 100 m s |   |
| 測定精度 | 流量        | 精度等級5 (排水流量計 J I S B 7 5 5 7)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・自然流下の場合に限る</li> <li>・最大流量は水路形状、最大水位、最大流速などで制限される</li> </ul> 逆流 : 判別可能  |
| 測定方式 | 流量        | 流速水位演算方式  |
|      | 水位        | 使用する水位計に依存<br>(MRF-10はマイクロ波パルス伝搬時間方式)   |
|      | 流速        | 超音波パルスドップラ方式  |



## 7. 2 本体仕様

(1)

|   |  |  |
|---|--|--|
| 本体構成                                    | 流速計測部と流量演算部は一体とし、水位計測部はMRF-10、または他の4-20mA電流出力を持つ水位計とする |  |
| 水位<br>アナログ入力<br>(HPWR、<br>HIN、<br>HRTN) | 入力内容   | 水位計からの水位信号   |
|   | 接続対象<br>機器仕様   | ①電波レベル計MRF-10<br>(注) 二線式水位計用電源DC24V±20%<br>②4-20mA電流出力を持つ水位計<br>(注) 許容負荷抵抗350Ω以上 |
|   | 入力形式   | 4-20mA DC電流入力<br>・絶縁耐圧：DC 500V<br>・最大定格電流：30mA                                   |
|   | 入力端子   | 端子台 (スプリング式)<br>・単線：28~14AWG<br>・可とう燃線：28~14AWG                                  |
| 流量値<br>アナログ出力<br>(QO)                   | 出力内容   | 流量値  |
|   | 出力形式   | 4-20mA DC電流出力<br>・絶縁耐圧：DC 500V<br>・許容負荷抵抗：750Ω以下                                 |
|   | 【※】<br>応答<br>スピード                                      | 10~3600秒 (90%応答時間)   |
|   | 【※】<br>出力<br>パターン                                      | 出力パターン表7-2を参照<br>  逆流最大流量   = 正流最大流量<br>正逆判別は方向判別接点出力 (QBW) によって得られる             |
| 出力端子                                    | 端子台 (スプリング式)<br>・単線：28~14AWG<br>・可とう燃線：28~14AWG        |  |
| 水位値<br>アナログ出力<br>(HO)                   | 出力内容   | 水位値  |
|   | 出力形式   | 4-20mA DC電流出力<br>・絶縁耐圧：DC 500V<br>・許容負荷抵抗：750Ω以下                                 |
|   | 出力<br>パターン   | 出力パターン表7-2を参照 (ただし+のみ)   |
|   | 出力端子   | 端子台 (スプリング式)<br>・単線：28~14AWG<br>・可とう燃線：28~14AWG                                  |
| 流速値<br>アナログ出力<br>(VO)                   | 出力内容   | 流速値  |
|   | 出力形式   | 4-20mA DC電流出力<br>・絶縁耐圧：DC 500V<br>・許容負荷抵抗：750Ω以下                                 |
|   | 【※】<br>出力<br>パターン                                      | 出力パターン表7-2を参照<br>  逆流最大流速   = 正流最大流速<br>正逆判別は方向判別接点出力 (QBW) によって得られる             |
|   | 出力端子   | 端子台 (スプリング式)<br>・単線：28~14AWG<br>・可とう燃線：28~14AWG                                  |
| 積算出力<br>(INTGF、<br>INTGB)               | 出力内容   | 積算カウントアップ信号  |
|   | 出力形式   | パワーフォトMOSリレー出力<br>・接点閉時間：約100ms<br>・絶縁耐圧：AC 2500V                                |

|                                    |             |  |
|------------------------------------|-------------|--|
|                                    | 接点容量        | AC 3～264V<br>DC 3～125V<br>0.6A (40℃以上で要ディレーティング、0.4A@60℃)  |
|                                    | 積算方向        | 出力は正流逆流独立、設定は正流逆流共通  |
|                                    | 【※】<br>積算単位 | 1000m <sup>3</sup> (*1)、100m <sup>3</sup> 、10m <sup>3</sup> 、1m <sup>3</sup> 、<br>0.1m <sup>3</sup> 、0.01m <sup>3</sup> 、0.001m <sup>3</sup><br>(*1) 例えば1m <sup>3</sup> は1m <sup>3</sup> を表す   |
|                                    | 出力端子        | 端子台 (スプリング式)<br>・単線：28～14AWG<br>・可とう燃線：28～14AWG  |
| 異常警報出力<br>(CNT1、<br>CNT2、<br>CNT3) | 【※】<br>出力内容 | 下記を任意に出力可能 (警報時：閉)<br>HERR、VERR、TERR、ALL、QBW、NONE<br><br>HERR：水位に対して指定範囲外の値を取得した場合<br>(HROFFまたはHHAULT表示時)<br>VERR：流速計測にて断線が発生した場合<br>(VERR表示時)<br>TERR：水温計測にて指定範囲外の値を取得した場合<br>(TERR表示時)<br>ALL：HERR+VERR+TERR<br>QBW：方向判別 (逆流時：閉、正流時：開)<br>NONE：異常警報出力なし (常時：開) |
|                                    | 出力形式        | パワーフォトMOSリレー<br>・絶縁耐圧：AC 2500V   |
|                                    | 接点容量        | AC 3～264V<br>DC 3～125V<br>0.6A (40℃以上で要ディレーティング、0.4A@60℃)  |
|                                    | 出力端子        | 端子台 (スプリング式)<br>・単線：28～14AWG<br>・可とう燃線：28～14AWG  |
|                                    | 流速検出器出力     | 1 測線計測 標準仕様<br>2 測線計測 付加仕様 外部の測線切換器は不要<br>3 測線計測 付加仕様 外部の測線切換器は不要<br>4 測線計測 付加仕様 外部の測線切換器は不要   |

(2)

|            |      |  |
|------------|------|--|
| データの<br>設定 | 設定方式 | 流量演算部と流速計測部：16個のキーと表示器による対話式<br>水位計測部：使用する水位計に依存<br>(MRF-10はHARTモデムとPCを接続し、専用ソフトで設定) |
|            | 設定項目 | アナログ出力などの各種設定  |
| 表示         | 表示方式 | バックライト付き16桁×16行液晶表示器   |
|            | 表示内容 | 流量値、測定単位、各種動作表示などの測定データ  |

|            |                                    |   |   |
|------------|------------------------------------|---|---|
|            | <b>【※】</b><br>表示桁数                 | 流量値：設定した最大流量値に依存<br>(符号、小数点を含めて最大6桁)<br>水位値：設定した最大水位値に依存<br>(小数点を含めて最大5桁)<br>流速値：設定した最大流速値に依存<br>(符号、小数点を含めて最大6桁)<br>積算値：6桁 |   |
| 動作表示       | 流量値                                | "流量単位"を表示(逆流はマイナス表示)  |   |
|            | 積算値                                | 積算動作中の場合"INTG"を表示   |   |
|            | AGC                                | 流速計測にてAGCがONに設定されている場合"VAGC"を表示   |   |
|            | 受波なし                               | 水位計測にて受波なし処理中は"HROFF"を表示  |   |
|            | 断線・故障等                             |   | 流速計測にて断線発生時は"VERR"を表示   |
|            |                                    |   | 水位計測にて値が0%以下になった場合"HHALT"を表示  |
|            | 各種チェック                             |   | 温度計測にて値が範囲外になった場合"TERR"を表示  |
|            |                                    |   | 流量のアナログ出力チェック時："CHK-Q"を表示<br>流速のアナログ出力チェック時："CHK-V"を表示<br>水位のアナログ出力チェック時："CHK-H"を表示<br>測線切換チェック時："CHK-M"を表示<br>複合チェック時は"CHK-HVQM"のように表示 |
| フルスケールオーバー | 各計測値がアナログ出力で表現できる範囲を越えている場合"FS"を表示 |   |   |
| 電池残量       | メモリバックアップ用電池の電圧が規定値以下になった場合"LB"を表示 |   |   |

(3)

|    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 機能 | <b>【※】</b><br>受波なし処理       | 水位計測にて受波なし発生時、または流速計測ですべての流速検出器が断線となったときは直前の値を保持。その際、流量出力値は0%、100%、HOLD(直前の値を保持)から選択可能                                 |
|    | <b>【※】</b><br>受波なし処理開始時間   | 使用する水位計に依存<br>MRF-10の場合1~120s  |
|    | 自己診断                       | 電源投入時および、メニューにてセルフチェック可能   |
|    | <b>【※】</b><br>アナログ出力チェック機能 | アナログ出力の疑似出力が可能<br>設定範囲<br>流量、流速：スパンに対して-100.0~100.0%<br>水位：スパンに対して0.0~100.0%<br>(小数点以下最大1桁)                            |
|    | <b>【※】</b><br>低流量カット       | 指定した流量値以下の流量をカット可能<br>(正逆流時個別に設定可能)<br>設定範囲：<br>正流時：0.0000~99999 [設定流量単位]<br>逆流時：-99999~0.0000 [設定流量単位]<br>(小数点以下最大4桁) |
|    | <b>【※】</b><br>流量ゼロ補正       | 指定した流量分だけゼロ点を補正可能<br>(正逆流時個別に設定可能)<br>設定範囲：-99999~99999 [設定流量単位]<br>(小数点以下最大4桁)  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 【※】<br>流量スパン<br>補正           | スパン直線の傾きを補正可能<br>(正逆流個別に設定可能)<br>設定範囲: 0.100~2.000 (小数点以下最大3桁)   |
| 【※】<br>たまり水カ<br>ット           | たまり水水位を設定しこれ以下のとき流量をゼロとする<br>設定範囲: 0.000~5.000m (小数点以下最大3桁)  |
| 【※】<br>流速計測自<br>動ゲイン制<br>御機能 | 流速計測に適切なゲインを自動的に設定可能<br>流速計測中の受信感度変動に対して一定レベルを保つよう<br>にゲインを自動的に制御可能<br>注) 瞬時の変動には反応させていない<br>当社サービス員などにより、オシロスコープで波形を確認<br>しながら手動での設定も可能 |
| 基礎データ<br>表示機能                | 本体内部の計算値の一部を表示可能   |
| 【※】<br>測線切替チ<br>ェック機能        | 多測線流速計測の場合、強制的に測線を固定し、測線毎の<br>計測チェックが可能  |
| 【※】<br>低流速カッ<br>ト            | 指定した流速値以下の流速をカット可能<br>(正逆流時個別に設定可能)<br>設定範囲:<br>正流時: 0.000~5.000m/s<br>(小数点以下最大3桁)<br>逆流時: -5.000~0.000m/s<br>(小数点以下最大3桁)                |
| 【※】<br>流速ゼロ補<br>正            | 指定した流速分だけゼロ点を補正可能<br>(正逆流時個別に設定可能)<br>設定範囲: -5.000~5.000m/s<br>(小数点以下最大3桁)   |
| 【※】<br>流速スパン<br>補正           | スパン直線の傾きを補正可能<br>(正逆流個別に設定可能)<br>設定範囲: 0.100~2.000 (小数点以下最大3桁)   |
| 【※】<br>水位ゼロ補<br>正            | 指定した水位分だけゼロ点を補正可能<br>設定範囲: -5.000~5.000m (小数点以下最大<br>3桁)   |
| 【※】<br>水位スパン<br>補正           | スパン直線の傾きを補正可能<br>設定範囲: 0.100~2.000 (小数点以下最大3桁)   |
| 【※】<br>水位固定                  | 最大水位に固定可能 (水位計不使用)   |
| メモリ保護                        | 電池にてバックアップされたメモリで積算値を保持<br>保持期間: 約5年 (常温、本体電源断時、環境に依存、充<br>電不可)<br>不揮発性メモリで設定値などを保持  |

(4)

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| 排水流量計<br>JIS対応 | パスワードによる保護 | 変換器のメニューに入る際はパスワードの入力が必要<br>ユーザ数は5人まで<br>水位計は使用する水位計に依存。MRF-10の場合はパスワードの入力が必要。 |
|                | アクセス記録保存   | メニューに入った日時とユーザを内部メモリに記憶。シリアル通信にてPCに送信可能  |
|                | 積算値保存      | 電源をOFF (または停電) 直前の値を内部メモリに保存   |

(5)

|            |   |
|------------|---|
| 電源         | AC 90~264V、50/60Hz±2Hz<br>瞬時停電対応時間は10ms<br>入力端子：端子台 (スプリング式)、24~8AWG  |
| 消費電力       | AC100V時：35VA以下<br>AC240V時：45VA以下  |
| ヒューズ<br>定格 | AC電源用：3.15A<br>サービスコンセント用 (AC 100Vの場合のみ)：3.15A<br>すべてタイムラグタイプ   |
| 避雷器        | アナログ出力及びAC電源ラインに内蔵<br>性能：IEC61000-4-5に基づき試験を実施し本体回路に故障が生じないこと<br>試験レベル<br>AC電源ライン コモンモード 4kV ノーマルモード 2kV<br>アナログ出力ライン コモンモード 4kV ノーマルモード 2kV<br>(注) 直撃雷やあらゆるレベルの誘導雷から保護できるものではありません |

(6)

|         |   |
|---------|---|
| 使用温度範囲  | -10~55℃   |
| 使用湿度範囲  | 95%RH以下 ただし非結露  |
| 取付方法    | 壁取付型  |
| 構造      | IP52 (カテゴリー2)<br>(JIS C 0920、IEC 60529)               |
| 電気配線接続口 | スキントップ 9個<br>適合ケーブル：(φ6~12、下穴：φ23)×5、(φ9~14、下穴：φ23)×4 |
| ケース材質   | 鋼板  |
| 塗装      | メラミン樹脂焼き付け塗装  |
| 塗色      | マンセル10YR9.4/0.5                                       |
| 質量      | 10kg以下  |
| 寸法      | 図7-1を参照   |

### 7. 3 付加仕様

|         |  |
|---------|--|
| 多測線流速計測 | 水路の直線部が短い場合、あるいは流速分布が乱れている様な水路に適用する<br>水位に連動して使用流速検出器を自動的に切り換え可能<br>測線数：2～4<br>(注) 測線数に応じた流速検出器と流速検出器用ケーブルが必要となる |
|---------|--|

### 7. 4 水位計仕様

|     |  |
|-----|--|
| 水位計 | 使用する水位計に依存<br>接続対象とする水位計については7. 2 本体仕様の「水位アナログ入力」を参照 |
|-----|--|

### 7. 5 流速検出器仕様

|       |  |
|-------|--|
| 流速検出器 | 下記から選択<br>・SE200020 (WL-20) . . . . . 小形水路用<br>・SE204020 (PL-20B20) . . . . . 大形管渠用<br>・SE200010 . . . . . 小形管渠用 |
|-------|--|

### 7. 6 水温検出端











|       |                 |
|-------|-----------------|
| 水温検出端 | TH-200またはTH-100 |
|-------|-----------------|

### 7. 7 オプション品

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| アクセスログ出力ケーブル | PCのシリアルポート (D-Sub 9ピン) との接続用 |
|--------------|------------------------------|



【※】 排水流量計JIS対応版では、お客様による変更はできません。変更の際は、当社サービス員にお申し付けください。

表 7-1 必要とする水路直線部
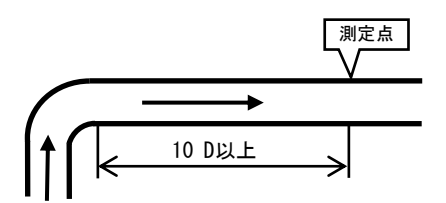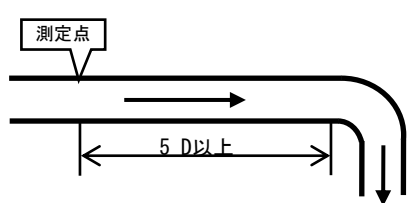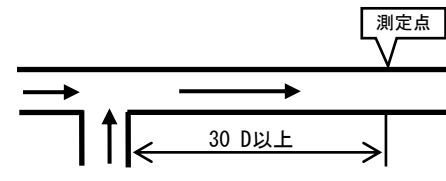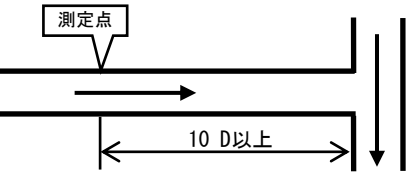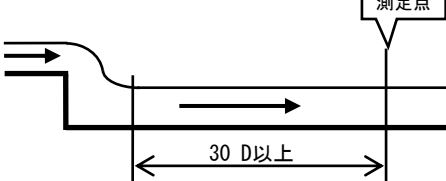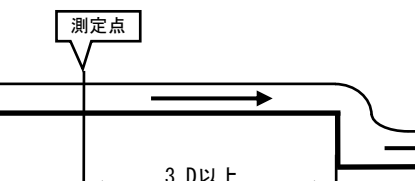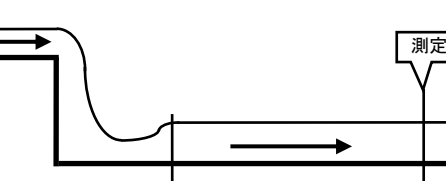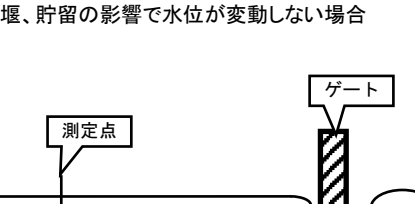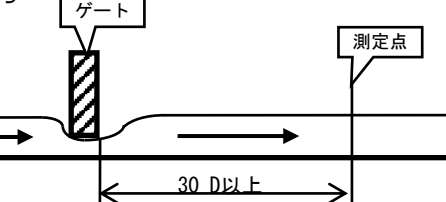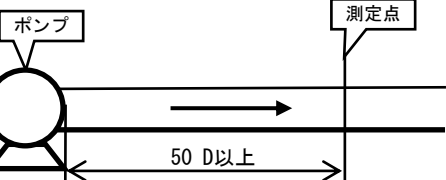
| 上流側直線長  | 下流側直線長   |
|---|--|
| <p>曲がりから</p>         | <p>曲がりまで</p>                                       |
| <p>合流から</p>          | <p>合流まで</p>                                        |
| <p>落ち込みから</p>       | <p>落ち込みまで</p>                                     |
| <p>大規模な落ち込みから</p>  | <p>ゲート、堰、貯留まで<br/>(1)ゲート、堰、貯留の影響で水位が変動しない場合</p>  |
| <p>ゲートから</p>       | <p>(2)ゲート、堰、貯留の影響で水位が変動する場合<br/>多測線測流速測定の実用など要相談</p>   |
| <p>ポンプから</p>       |  |

D : 管径

表 7-2 アナログ出力タイプ
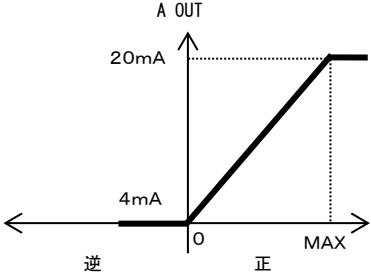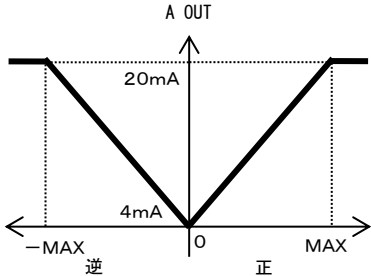
| タイプ名称 | 出力   |
|-------|--|
| +     |  <p>The graph shows the output current (A OUT) on the vertical axis and the input signal on the horizontal axis. The output starts at 4mA when the input is 0. As the input increases towards MAX, the output increases linearly to 20mA. Beyond MAX, the output remains constant at 20mA. The region to the left of 0 is labeled '逆' (reverse) and the region to the right of 0 is labeled '正' (positive).</p>  |
| + / - |  <p>The graph shows the output current (A OUT) on the vertical axis and the input signal on the horizontal axis. The output is constant at 20mA for negative inputs. As the input increases from 0, the output decreases linearly to a minimum of 4mA at the input value 0. Beyond 0, the output increases linearly back to 20mA at the input value MAX. For inputs greater than MAX, the output remains constant at 20mA. The region to the left of 0 is labeled '逆' (reverse) and the region to the right of 0 is labeled '正' (positive). The maximum negative input is labeled '-MAX'.</p> |



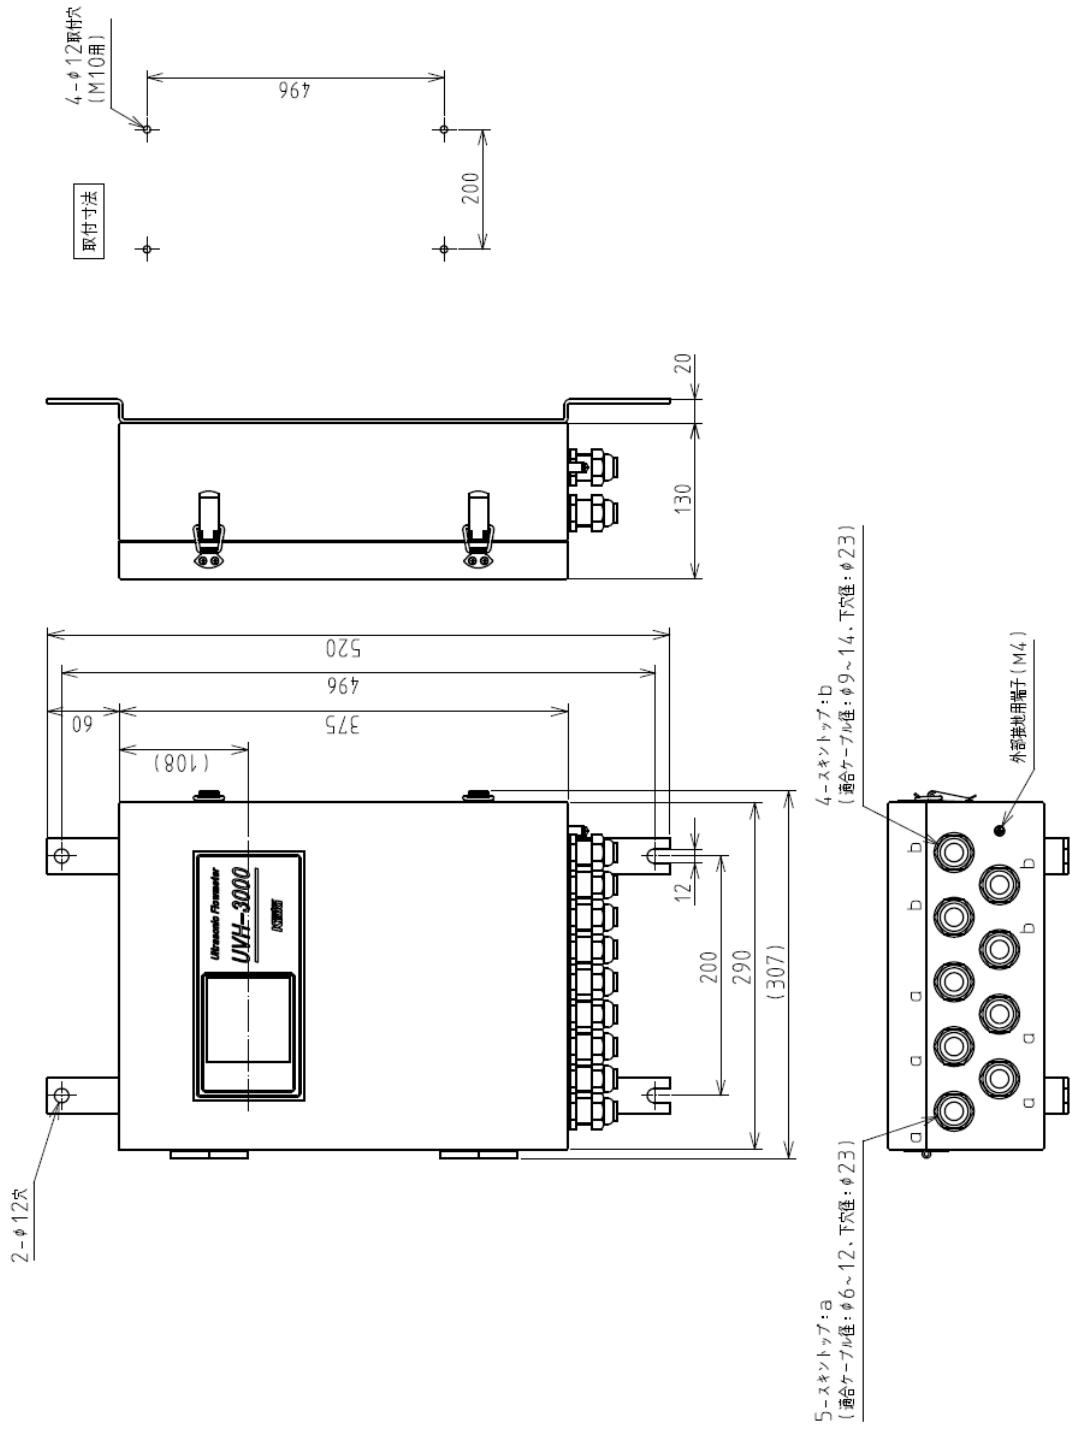


図7-1 UVH-3000外形寸法

## 第8章. 流量計測定原理

管渠流量計UVH-3000は、自由水面をもって流れる流体の流速を流速計部（超音波ドップラ方式）で、水位はお客様ご指定の水位計によって測定し、これらの情報を元に流量演算を行い、流量を求めています。

一般に管渠の流量 $Q$ は、流水断面積 $A$ と平均流速 $V$ の積で与えられます。

$$Q = A \times V$$

ここで流水断面積 $A$ は水路形状と水位 $H$ から求まります。一方平均流速 $V$ は、本機器では超音波ドップラ方式を用いているので、点流速 $V_p$ と理論及び実験で求めた点補正係数 $K_p$ の積で求めることができます。

$$Q = A(H) \times K_p(H) \times V_p$$

すなわち、水位計で $H$ を測定し、 $H$ の関数である $A$ 、 $K_p$ を計算し、それと流速計で測定した点流速 $V_p$ との演算を行い、流量 $Q$ を算出します。

流速分布が乱れている水路においては多測線測定（2～4測線）を用います。

水位が流速検出器以下になり流速測定が不能になると、Manning公式を用いて流量を算出します。

(このページは意図的に白紙にしています)

## 営業所一覧

本機器の故障や修理等の御相談は最寄りの営業所まで御連絡ください。

|          |   |
|----------|---|
| 本社／東京営業所 | 〒144-8551 東京都大田区南蒲田2-16-46<br>TEL 03-3737-8621 FAX 03-3737-8665               |
| 札幌営業所    | 〒003-0802 北海道札幌市白石区菊水二条2-2-12 藤井ビル菊水IV<br>TEL 011-816-6291 FAX 011-816-6296   |
| 仙台営業所    | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-12-12 L.Biz仙台<br>TEL 022-295-5910 FAX 022-295-6041    |
| 北関東営業所   | 〒327-0816 栃木県佐野市栄町1-1 佐野工場内<br>TEL 0283-21-0341 FAX 0283-21-0175              |
| 名古屋営業所   | 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-14-11 DPスクエア東桜 8F<br>TEL 052-228-3996 FAX 052-228-3995 |
| 大阪営業所    | 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-26<br>TEL 06-6150-6602 FAX 06-6150-6610             |
| 広島営業所    | 〒730-0041 広島県広島市中区小町3-19リファレンス広島小町ビル<br>TEL 082-249-4661 FAX 082-241-7199     |
| 福岡営業所    | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-8-15博多鳳城ビル5F<br>TEL 092-414-7280 FAX 092-414-7281    |

(このページは意図的に白紙にしています)

文書番号 K 2 1 - 0 1 1 A

**管渠流量計 UVH-3000 排水 JIS 対応版  
取扱説明書**

2022 年 7 月 初版発行

2024 年 2 月 第 2 版発行

発行 東京計器株式会社  
計測機器システムカンパニー  
〒144-8551  
東京都大田区南蒲田 2-16-46  
TEL 03-3737-8621  
FAX 03-3737-8665  
URL <https://www.tokyokeiki.jp/>

当社の許可なくしてこの取扱説明書を転載複  
写することを禁止します。  
この取扱説明書の内容は予告なく変更される  
場合があります。